

2021年5月

お得意様各位

株式会社コスミックコーポレーション
〒112-0002 東京都文京区小石川 2-7-3 富坂ビル
電話 03-5802-5971



干渉チェック・Aプラスの色見本

拝啓 時下益々ご清祥の事と、お慶び申し上げます。平素より弊社商品を御利用いただきまして、誠にありがとうございます。

弊社では妨害物質の影響の評価に干渉チェック・Aプラスを使用しております。この度、下記のとおり、色見本（濃度別画像データ）を作成いたしましたので、臨床検査業務の参考用資料としてご参照頂けますと幸甚です。

引き続き倍旧のご厚情を賜りたく、何卒宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

別紙1

①ビリルビン F および②ビリルビン C の各濃度別画像データ


別紙2

③溶血ヘモグロビンおよび④乳びの各濃度別画像データ

以上


別紙 1

① ビリルビン F

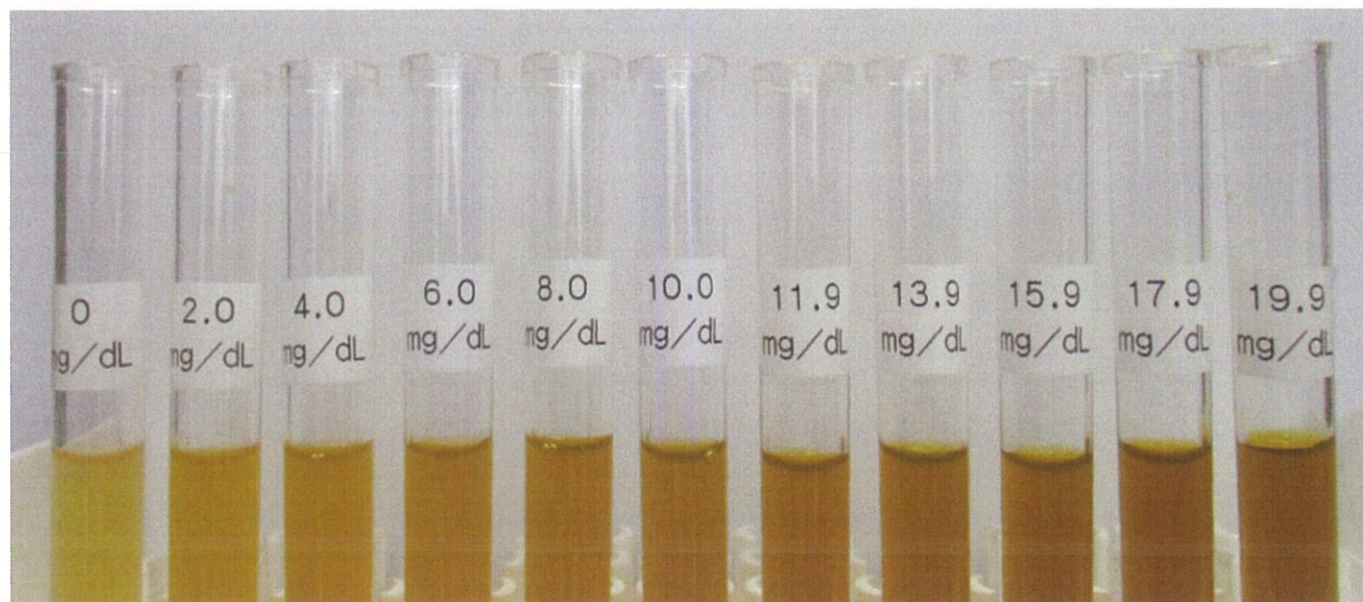

写真左より、0mg/dL、2.0mg/dL、4.0mg/dL、6.0mg/dL、8.0mg/dL、10.0mg/dL、11.9mg/dL、13.9mg/dL、15.9mg/dL、17.9mg/dL、19.9mg/dL。


② ビリルビン C

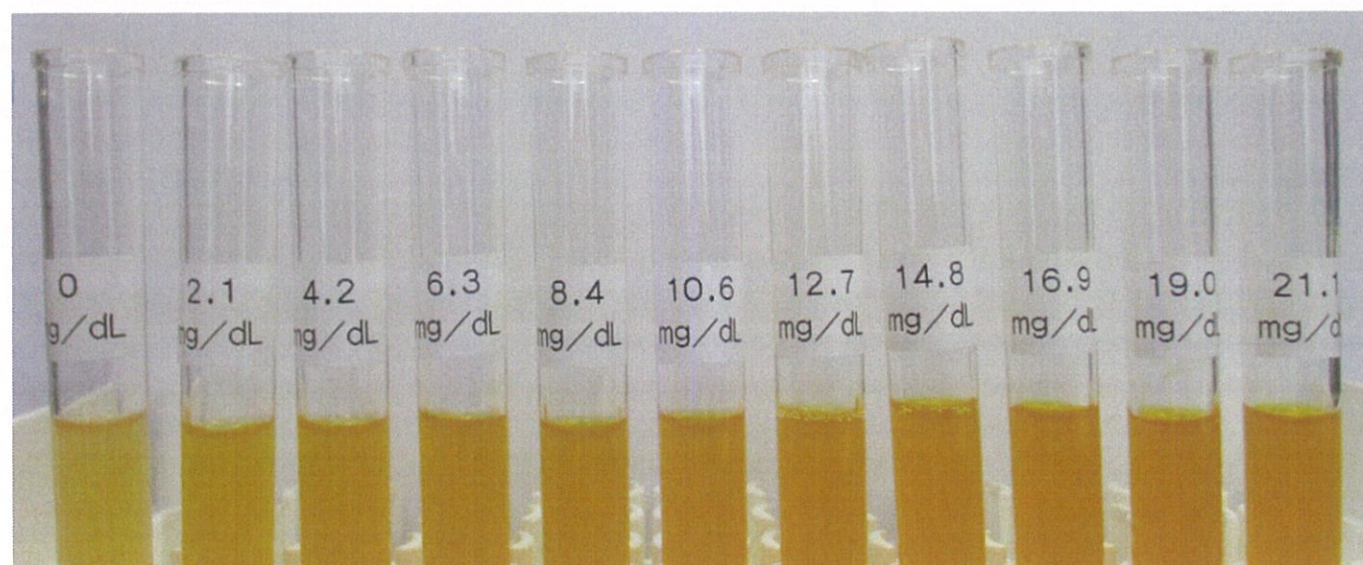

写真左より、0mg/dL、2.1mg/dL、4.2mg/dL、6.3mg/dL、8.4mg/dL、10.6mg/dL、12.7mg/dL、14.8mg/dL、16.9mg/dL、19.0mg/dL、21.1mg/dL。


別紙 2

③溶血ヘモグロビン

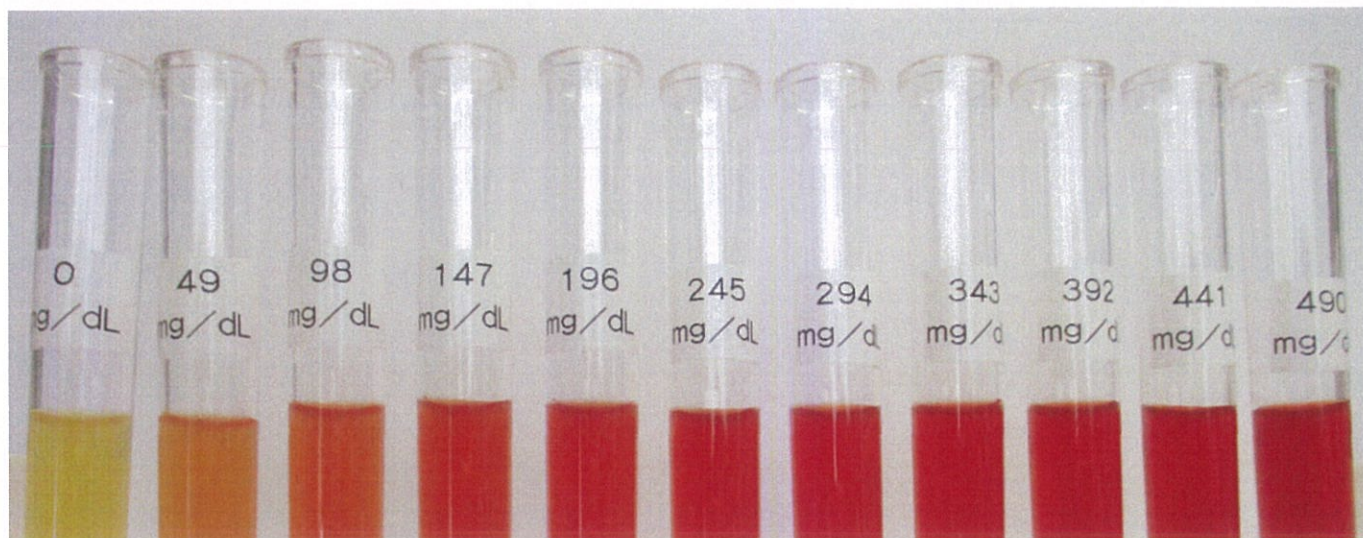

写真左より、0mg/dL、49mg/dL、98mg/dL、147mg/dL、196mg/dL、245mg/dL、294mg/dL、343mg/dL、392mg/dL、441mg/dL、490mg/dL。

④乳び

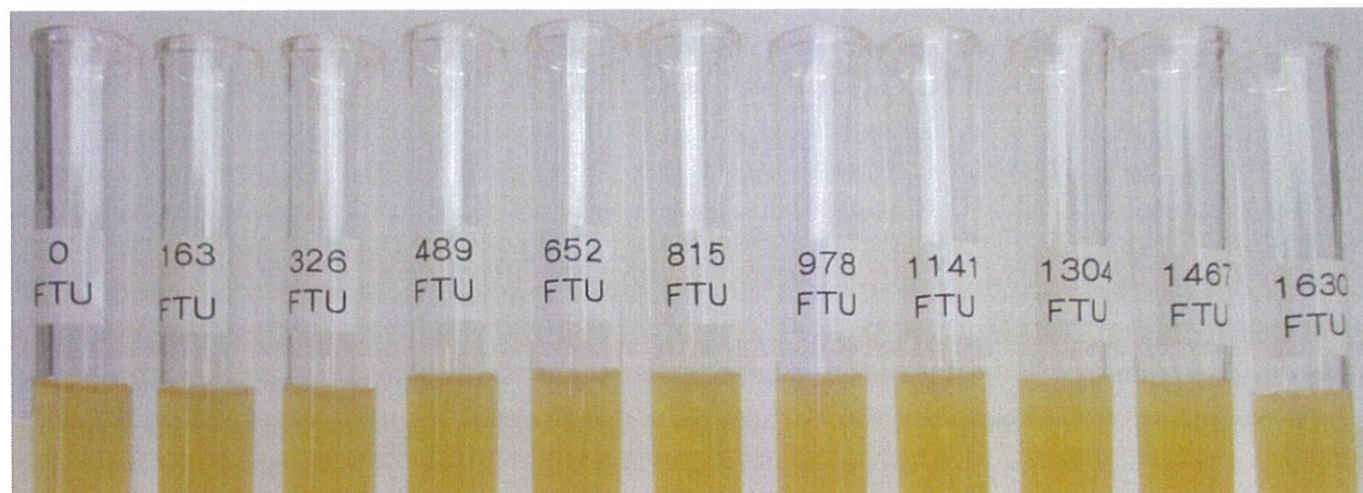

写真左より、0FTU、163FTU、326FTU、489FTU、652FTU、815FTU、978FTU、1141FTU、1304FTU、1467FTU、1630FTU。